MEDICAL
BUSINESS
COMMUNITY

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

CONMED

Система восстановления плечевого сустава

Компактная, надежная, легкая в использовании –
наша система становится новым стандартом в сфере восстановления суставной губы и суставной капсулы.

Якорный фиксатор PressFT™

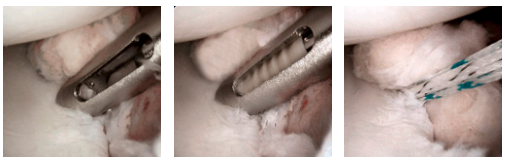

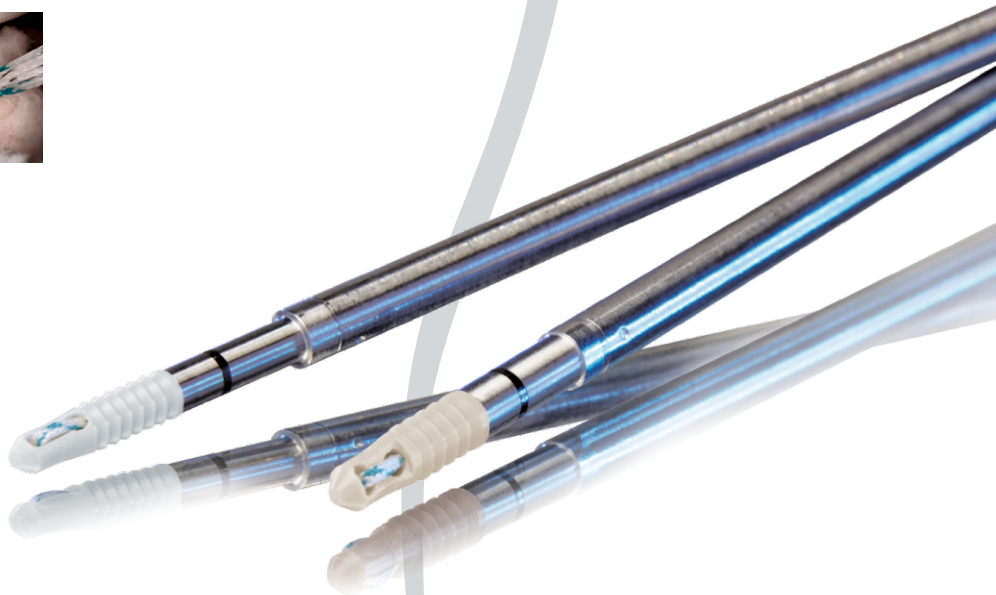

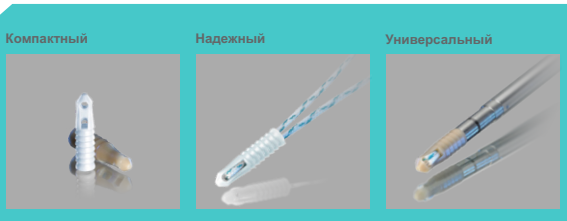

СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА





Минимальный размер якорного фиксатора PressFT™ позволяет увеличить количество точек фиксации и упрощает крепление вдоль края гленоида.

Исключительная надежность.

Даже мельчайшие детали из серии фиксаторов PressFT™ способы выдержать силу тяги до 200 Н, а уровень смещения под цикличной нагрузкой составляет менее 1 мм.

Простой и универсальный.

Сделайте отверстие, установите фиксатор – крепление готово. Доступны фиксаторы размером 2.1 и 2.6 с единичной или двойной нитью HiFi. Фиксатор может быть изготовлен из биокомпозитных материалов PEEK или GENESYS™. Они проницаемы для излучения и подаются сверлению.

Объем

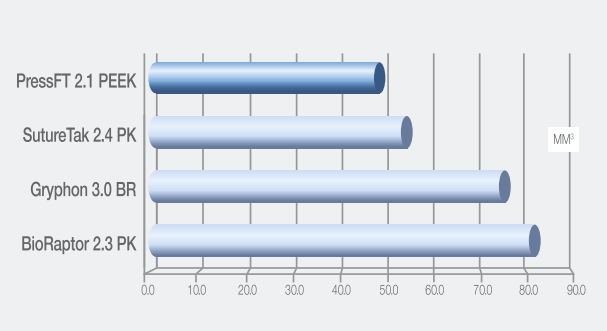

Вырывное усилие в кортикальной кости 2,3,4 (свиная бедренная кость)

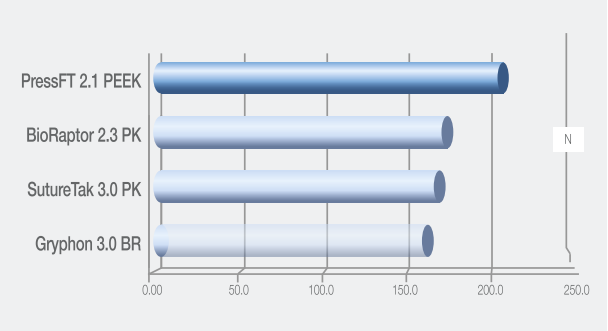

Компактные. Безопасные для связок. Универсальные решения для восстановления плечевого сустава.

Дизайн без наконечника

Фиксатор составляет 50% длины, что снижает риск протрузии.

Ушко на конце фиксатора

Ушко расположено ближе к концу для более надежной фиксации.

Полное врастание в кость

Доказано: биокомпозитный материал GENESYS™ может успешно врастать в костную ткань.

Нить Hi-Fi® Suture

Оказывает меньшее трение на мягкие ткани и руки хирурга, чем нити других производителей

СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Информация для заказа

Описание	Кат.номер
PressFT 2.1mm Anchor w/one strand of #2 Hi-Fi - PEEK	NP211
PressFT 2.1mm Anchor w/two strands of #0 Hi-Fi - PEEK	NP212
PressFT 2.6mm Anchor w/one strand of #2 Hi-Fi - PEEK	NP261
PressFT 2.6mm Anchor w/two strands of #1 Hi-Fi - PEEK	NP262
GENESYS PressFT 2.1mm Anchor w/one strand of #2 Hi-Fi	NB211
GENESYS PressFT 2.1mm Anchor w/two strands of #0 Hi-Fi	NB212
GENESYS PressFT 2.6mm Anchor w/one strand of #2 Hi-Fi	NB261
GENESYS PressFT 2.6mm anchor w/two strands of #1 Hi-Fi	NB262
PressFT 2.1mm Drill Bit	NDB21
PressFT 2.6mm Drill Bit	NDB26
Instability Drill Guide, Fishmouth	C6171A
Instability Drill Guide, Serrated	C6172A
Blunt Obturator	C6173
Sharp Trocar	C6174
Instrument Tray	C6178

conmed.com

MEDICAL BUSINESS COMMUNITY
mbcmed.ru
mbc@mbcmed.ru
+7 (351) 242-07-20